



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

28.07.2026 № 014-866/26

На № _____ от _____

О недоброкачественном
медицинском изделии



2642627

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных органов
Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании отрицательного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает о выявлении в обращении территориальным органом Росздравнадзора по Республике Калмыкия недоброкачественного медицинского изделия:

«Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные латексные неопудренные, текстурированные ТМ CONNECT; размер: L», LOT: 072025 3024, дата изготовления: 072025, использовать до: 072028, производства: «Шри Транг Глове (Таиланд) Паблик Компани Лимитед», Таиланд, регистрационное удостоверение от 11.04.2022 № РЗН 2021/13978 (см. приложение).

Субъектам обращения медицинских изделий предлагается провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению его обращения, о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена



административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», установлена уголовная ответственность согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.


Приложение: Таблица сопоставления параметров и характеристик, указанных в комплекте регистрационной документации, с параметрами и характеристиками образцов выявленного медицинского изделия, а также фотоизображение выявленного медицинского изделия на 5 л. в 1 экз.

 А.В. Самойлова


Приложение к письму Росздравнадзора
от 28.07.2026 № ОИ - 866/26.

Таблица сопоставления параметров и характеристик, указанных в комплекте регистрационной документации, с параметрами и характеристиками образцов выявленного медицинского изделия

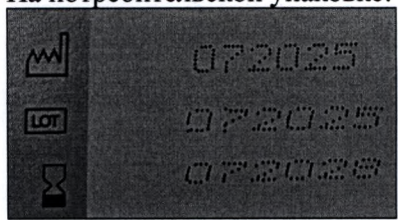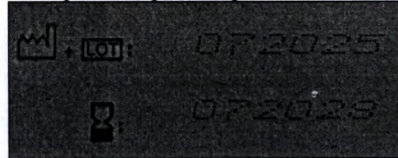Сравниваемые сведения/параметры	Комплект регистрационной документации (регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13978 от 11.04.2022, срок действия не ограничен)	Образцы выявленного медицинского изделия
Срок годности	<u>Согласно информации, из материалов КРД к РУ № РЗН 2021/13978 от 11.04.2022 (Технический документ):</u> Срок годности: 5 лет с даты изготовления.	На потребительской упаковке:  На транспортной упаковке: 
Санитарно-химические показатели	Цинк, мг/л Допустимое значение 0,10	1,558±0,280

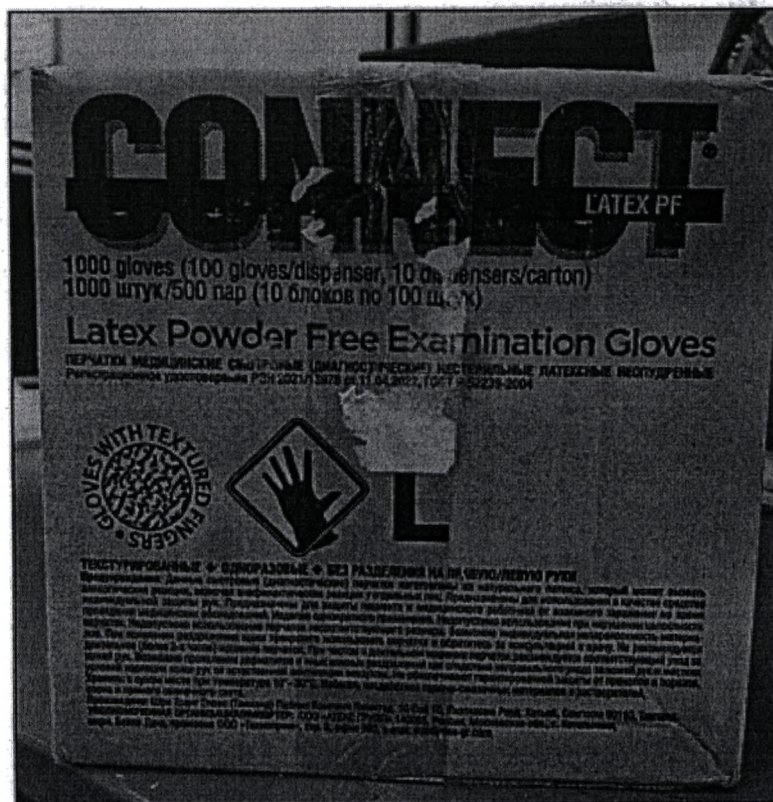

Транспортная тара (сторона б)

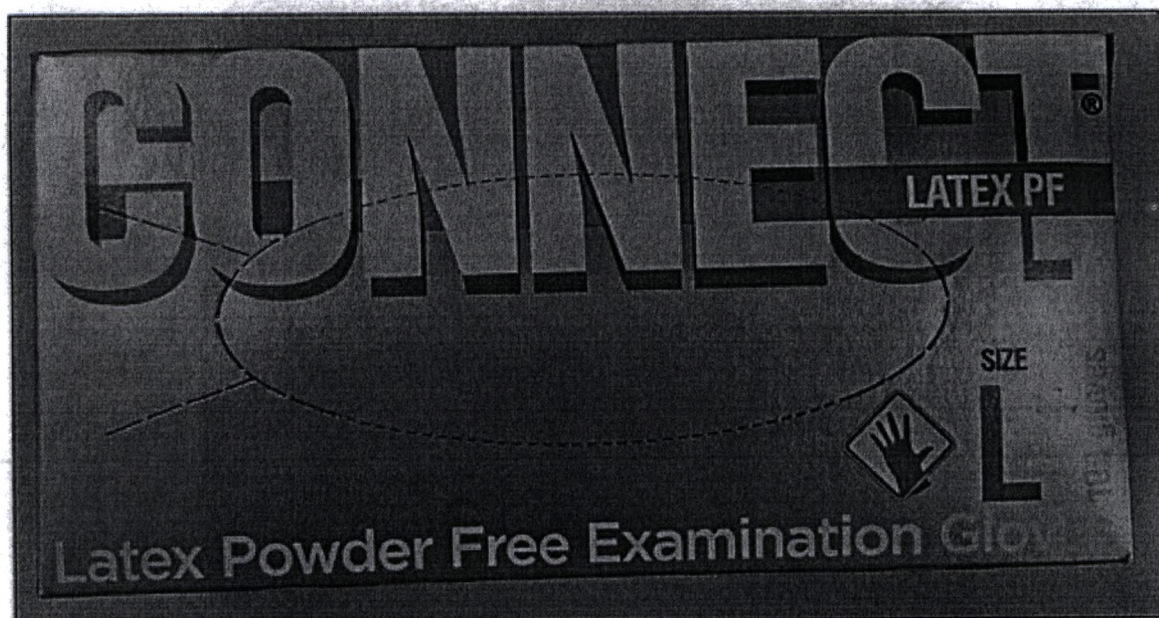

Потребительская тара (сторона 1)

[illegible]


GONNECT®
LATEX PF
Latex Powder Free Examination Glove

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ТОВАР (СТРОИТЕЛЬСТВО)


10 ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СМОТРОРЫ И (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ)
МЕДИЦИНСКИЕ ПАТЕКНЫЕ НЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ
ТУМАНОВЫЕ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ) Р-М 1021/11/39/76 от 11.04.2022, ГОСТ R 82338-2008
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
463 РАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ РУКИ
104 ШТУК (НО ПАР)

CONNECT


MD, EN60601, EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-1-3, EN60601-1-4, EN60601-1-5, EN60601-1-6, EN60601-1-7, EN60601-1-8, EN60601-1-9, EN60601-1-10, EN60601-1-11, EN60601-1-12, EN60601-1-13, EN60601-1-14, EN60601-1-15, EN60601-1-16, EN60601-1-17, EN60601-1-18, EN60601-1-19, EN60601-1-20, EN60601-1-21, EN60601-1-22, EN60601-1-23, EN60601-1-24, EN60601-1-25, EN60601-1-26, EN60601-1-27, EN60601-1-28, EN60601-1-29, EN60601-1-30, EN60601-1-31, EN60601-1-32, EN60601-1-33, EN60601-1-34, EN60601-1-35, EN60601-1-36, EN60601-1-37, EN60601-1-38, EN60601-1-39, EN60601-1-40, EN60601-1-41, EN60601-1-42, EN60601-1-43, EN60601-1-44, EN60601-1-45, EN60601-1-46, EN60601-1-47, EN60601-1-48, EN60601-1-49, EN60601-1-50, EN60601-1-51, EN60601-1-52, EN60601-1-53, EN60601-1-54, EN60601-1-55, EN60601-1-56, EN60601-1-57, EN60601-1-58, EN60601-1-59, EN60601-1-60, EN60601-1-61, EN60601-1-62, EN60601-1-63, EN60601-1-64, EN60601-1-65, EN60601-1-66, EN60601-1-67, EN60601-1-68, EN60601-1-69, EN60601-1-70, EN60601-1-71, EN60601-1-72, EN60601-1-73, EN60601-1-74, EN60601-1-75, EN60601-1-76, EN60601-1-77, EN60601-1-78, EN60601-1-79, EN60601-1-80, EN60601-1-81, EN60601-1-82, EN60601-1-83, EN60601-1-84, EN60601-1-85, EN60601-1-86, EN60601-1-87, EN60601-1-88, EN60601-1-89, EN60601-1-90, EN60601-1-91, EN60601-1-92, EN60601-1-93, EN60601-1-94, EN60601-1-95, EN60601-1-96, EN60601-1-97, EN60601-1-98, EN60601-1-99, EN60601-1-100, EN60601-1-101, EN60601-1-102, EN60601-1-103, EN60601-1-104, EN60601-1-105, EN60601-1-106, EN60601-1-107, EN60601-1-108, EN60601-1-109, EN60601-1-110, EN60601-1-111, EN60601-1-112, EN60601-1-113, EN60601-1-114, EN60601-1-115, EN60601-1-116, EN60601-1-117, EN60601-1-118, EN60601-1-119, EN60601-1-120, EN60601-1-121, EN60601-1-122, EN60601-1-123, EN60601-1-124, EN60601-1-125, EN60601-1-126, EN60601-1-127, EN60601-1-128, EN60601-1-129, EN60601-1-130, EN60601-1-131, EN60601-1-132, EN60601-1-133, EN60601-1-134, EN60601-1-135, EN60601-1-136, EN60601-1-137, EN60601-1-138, EN60601-1-139, EN60601-1-140, EN60601-1-141, EN60601-1-142, EN60601-1-143, EN60601-1-144, EN60601-1-145, EN60601-1-146, EN60601-1-147, EN60601-1-148, EN60601-1-149, EN60601-1-150, EN60601-1-151, EN60601-1-152, EN60601-1-153, EN60601-1-154, EN60601-1-155, EN60601-1-156, EN60601-1-157, EN60601-1-158, EN60601-1-159, EN60601-1-160, EN60601-1-161, EN60601-1-162, EN60601-1-163, EN60601-1-164, EN60601-1-165, EN60601-1-166, EN60601-1-167, EN60601-1-168, EN60601-1-169, EN60601-1-170, EN60601-1-171, EN60601-1-172, EN60601-1-173, EN60601-1-174, EN60601-1-175, EN60601-1-176, EN60601-1-177, EN60601-1-178, EN60601-1-179, EN60601-1-180, EN60601-1-181, EN60601-1-182, EN60601-1-183, EN60601-1-184, EN60601-1-185, EN60601-1-186, EN60601-1-187, EN60601-1-188, EN60601-1-189, EN60601-1-190, EN60601-1-191, EN60601-1-192, EN60601-1-193, EN60601-1-194, EN60601-1-195, EN60601-1-196, EN60601-1-197, EN60601-1-198, EN60601-1-199, EN60601-1-200, EN60601-1-201, EN60601-1-202, EN60601-1-203, EN60601-1-204, EN60601-1-205, EN60601-1-206, EN60601-1-207, EN60601-1-208, EN60601-1-209, EN60601-1-210, EN60601-1-211, EN60601-1-212, EN60601-1-213, EN60601-1-214, EN60601-1-215, EN60601-1-216, EN60601-1-217, EN60601-1-218, EN60601-1-219, EN60601-1-220, EN60601-1-221, EN60601-1-222, EN60601-1-223, EN60601-1-224, EN60601-1-225, EN60601-1-226, EN60601-1-227, EN60601-1-228, EN60601-1-229, EN60601-1-230, EN60601-1-231, EN60601-1-232, EN60601-1-233, EN60601-1-234, EN60601-1-235, EN60601-1-236, EN60601-1-237, EN60601-1-238, EN60601-1-239, EN60601-1-240, EN60601-1-241, EN60601-1-242, EN60601-1-243, EN60601-1-244, EN60601-1-245, EN60601-1-246, EN60601-1-247, EN60601-1-248, EN60601-1-249, EN60601-1-250, EN60601-1-251, EN60601-1-252, EN60601-1-253, EN60601-1-254, EN60601-1-255, EN60601-1-256, EN60601-1-257, EN60601-1-258, EN60601-1-259, EN60601-1-260, EN60601-1-261, EN60601-1-262, EN60601-1-263, EN60601-1-264, EN60601-1-265, EN60601-1-266, EN60601-1-267, EN60601-1-268, EN60601-1-269, EN60601-1-270, EN60601-1-271, EN60601-1-272, EN60601-1-273, EN60601-1-274, EN60601-1-275, EN60601-1-276, EN60601-1-277, EN60601-1-278, EN60601-1-279, EN60601-1-280, EN60601-1-281, EN60601-1-282, EN60601-1-283, EN60601-1-284, EN60601-1-285, EN60601-1-286, EN60601-1-287, EN60601-1-288, EN60601-1-289, EN60601-1-290, EN60601-1-291, EN60601-1-292, EN60601-1-293, EN60601-1-294, EN60601-1-295, EN60601-1-296, EN60601-1-297, EN60601-1-298, EN60601-1-299, EN60601-1-300, EN60601-1-301, EN60601-1-302, EN60601-1-303, EN60601-1-304, EN60601-1-305, EN60601-1-306, EN60601-1-307, EN60601-1-308, EN

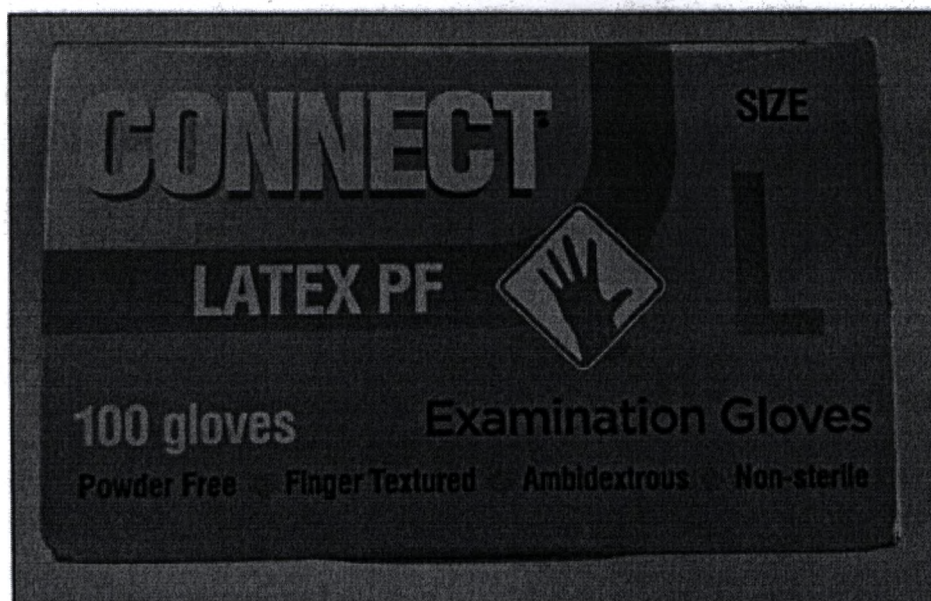

Потребительская тара (сторона 5)

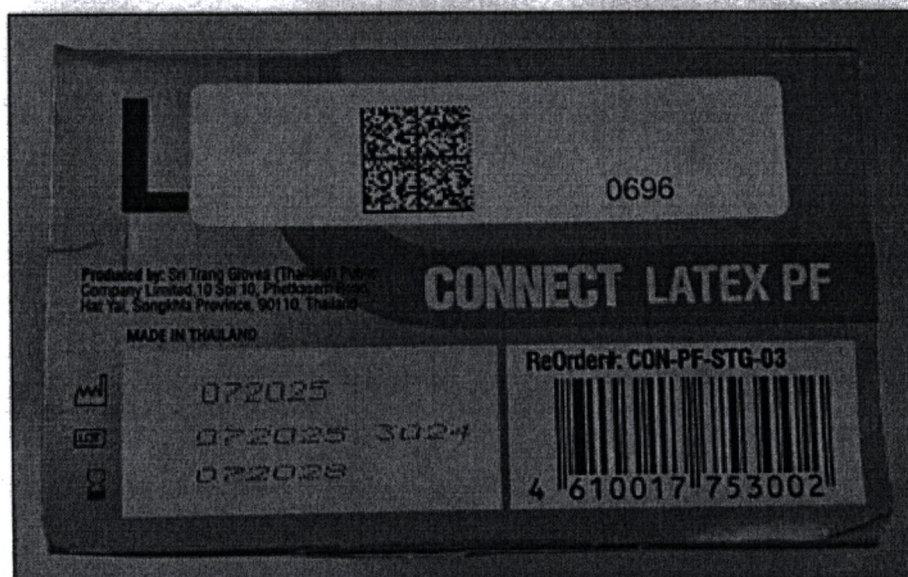

Потребительская тара (сторона 6)

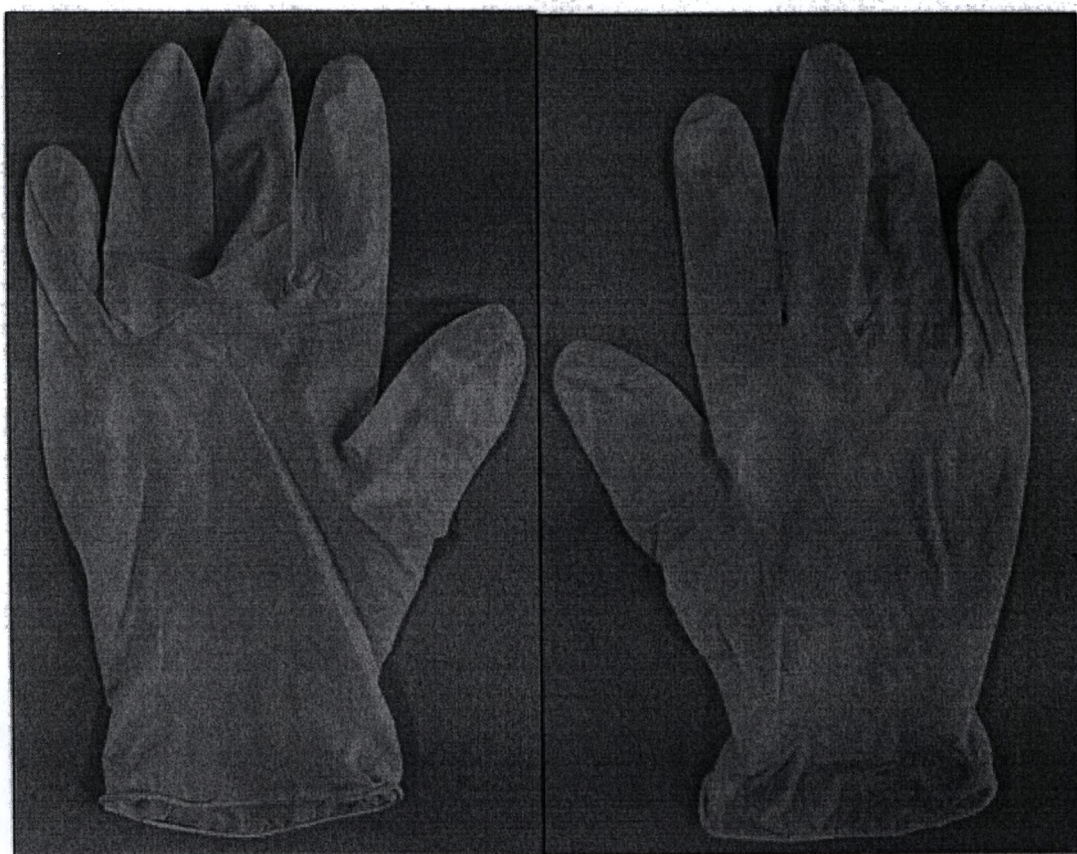

Перчатка (сторона 1, 2)