



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

14.09.2026 № 014-1061/26

На № _____ от _____

О фальсифицированном
медицинском изделии



2640639

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных органов
Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает о выявлении в обращении Территориальным органом Росздравнадзора по Ставропольскому краю фальсифицированного медицинского изделия:

«Кассеты сменные со скобами к аппаратам сшивающережущим ECHELON Flex Plus GST60G», партия/серия: GST60G/582A40, дата производства 2025-03-20, использовать до 2028-03-15, сопровождаемого сведениями о производителе "Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си", США, и регистрационным удостоверением от 23.12.2019 № ФСЗ 2011/08985 (далее - Медицинское изделие).

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении указанного Медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации недоброкачественного Медицинского изделия и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также установлена уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приложение: Таблица сопоставления параметров и характеристик, указанных в комплекте регистрационной документации, с параметрами и характеристиками образцов выявленного медицинского изделия на 6 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Сравниваемые сведения/параметры	Комплект регистрационной документации (регистрационное удостоверение от 23.12.2019 № ФСЗ 2011/08985 , срок действия не ограничен)	Образцы фальсифицированного медицинского изделия
	В соответствии с требованиями выписки из технического файла:  Количество элементов	<i>Сведения на маркировке отсутствуют</i>
	В соответствии с требованиями выписки из технического файла: Условно безопасно при МР (магнитно-  резонансном исследовании)	<i>Сведения на маркировке отсутствуют</i>
	В соответствии с требованиями выписки из технического файла: Продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия 	<i>Сведения на маркировке отсутствуют</i>

Фотоизображение фальсифицированного медицинского изделия

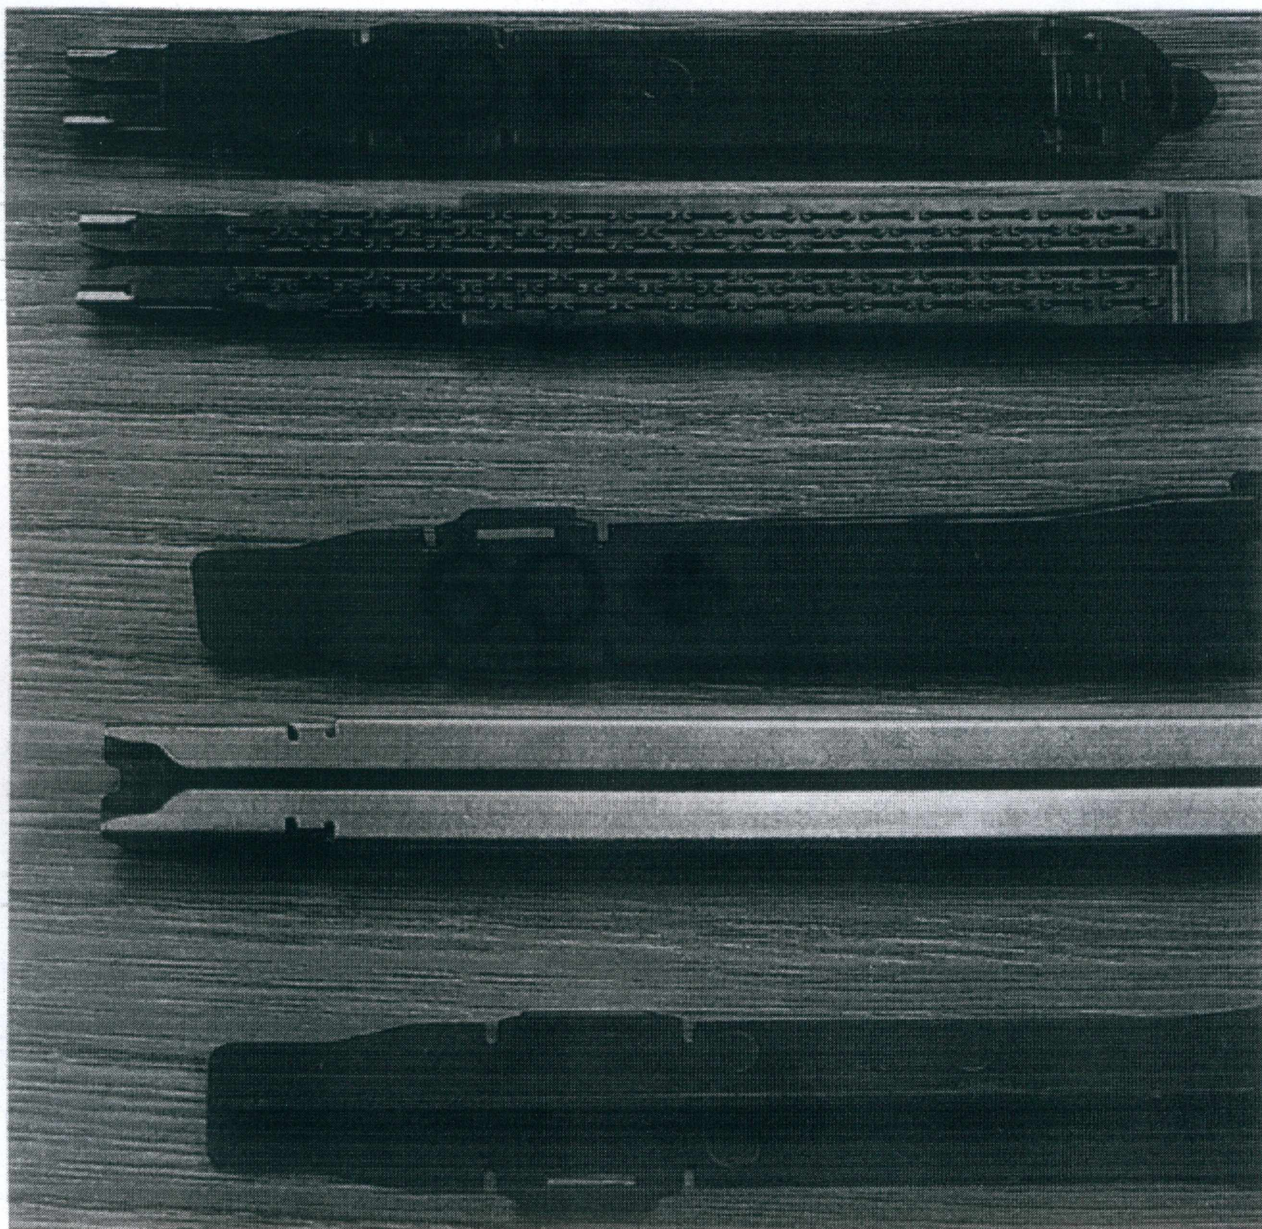

ETHICON
Echelon Endopath™

Endoscopic Linear
Cutter Reloads


Green

4.1
mm

6
Rows

60
mm

A95569P01



+ Gripping Surface
Technology

Chargeurs avec Technologie de surface Agrippante pour agrafeuse linéaire
cooptaire endoscopique | Vert | 4,1 mm | 6 rangées

Magazine mit strukturierter Oberfläche für endoskopische Linear Cutter
Grün | 4,1 mm | 6 Klammerreihen

Ricariche per suturatrice taglia e cucci endoscopica con tecnologia di superficie di
presa (gripping surface) | Verde | 4,1 mm | 6 file di punti

Recargas de agrafeador lineal con corte endoscópico con tecnología de superficie
de prensión | Verde | 4,1 mm | 6 filas

Cargas para endocortadora lineal endoscópica con tecnología de superficie de agarre
Verdes | 4,1 mm | 6 filas

Vullingen voor endoscopische lineaire cutter met grip-technologie
Groen | 4,1 mm | 6 rijen

Kavrama Yüzeyi Teknolojisi Sahip Endoskopik Lineer Kesici Kartuşları
Yeşil | 4,1 mm | 6 sıra

採用握持面技術の緑色線型切刺吻合器リロード
緑色 | 4.1mm | 6列

エンドスロトソック リニアーガンターカートリッジ
グリップングサーフェステクノロジー採用
グリーン | 4.1mm | 6列

REF QTY 12
GST60G
Catalogue Number

STERILIZED

Sterilized by
Irradiation



Do Not Use If Package
is Damaged



Consult Instructions
for Use



Do Not
Re-sterilize



Single Patient Use

Ethicon Endo-Surgery, Inc. ©2010

ETHICON™

PART OF THE JOHNSON & JOHNSON FAMILY OF COMPANIES



Ethicon Endo-Surgery, LLC
475 Cafe C
Guaynabo, PR 00989 USA

USA REP

Ethicon Endo-Surgery, Inc.
4545 Creek Road
Cincinnati, OH 45242-2839 USA
1-877-ETHICON
+1-513-337-8901 (English)

EC REP

Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH
Hummelstraße 21
22851 Norderstedt, GERMANY

ETHICON
Echelon Endopath

Reloads


Green

4.1
mm

6
Rows




Gripping Surface
Technology



60
mm

REF QTY 12
GST60G
Catalogue Number



Качество по стандарту и гарантия качества продукции
Echelon Endopath Reload GST60G
Ethicon Endo-Surgery, Inc. 26000
Ethicon Endo-Surgery, LLC, 475 Calle C, Gwynedd, Puerto
Rico, 00960, USA
Патентное право 2008/03/15
Echelon Endo-Surgery, Inc. 26000

Дата выпуска / Дата / Страна / Код / Код / Код / Код

ETHICON ENDO-SURGERY, LLC
475 Calle C
Gwynedd, PR 00960 USA
1-877-ETHICON
+1-513-337-8901 (English)
2028-03-20

Assembled in Mexico
pat. www.ethicon.com/patentmarking
www.e-ifu.com/symbols-glossary



(01)20705036014710



(17)280315(10)582A40

CE 0123

LOT 582A40

2028-03-15

00200 04702037 REF GST60G 04



582A40

2028-05-15




CE



ETHICON
Echelon Endopath™

A0000995P02



Stapling Surface
Technology

ETHICON ENDO-SURGERY, LLC
475 Calle C
Guaynabo, PR 00969 USA
1-877-ETHICON
+1-513-837-8901 (English)



Reload	60 mm Staple Line	4.1 mm	6 Rows
--------	----------------------	-----------	-----------

Chargeur, Magazin, Ricarica, Recarga, Carga,
Vulling, Kartus, 釘倉, カートリッジ



Sterilized by
Irradiation



Single Patient
Use



Do Not
Restertize



Consult Instructions
for Use



Do Not Use if Package
is Damaged



QTY 1

GST60G
Catalogue Number

©Ethicon Endo-Surgery, Inc. 2020

Assembled in Mexico

